Certificado de Garantia

Guarde este certificado junto com a nota fiscal, pois para a manutenção em garantia, será necessário apresentá-los.

Condições Gerais

O presente certificado garante o produto pelo prazo especificado, contra eventuais defeitos de fabricação ou de material, a partir da data da emissão da nota fiscal de venda e desde que o produto esteja sendo utilizado corretamente.

Utilização da garantia

Para fins de garantia, o proprietário deverá apresentar sempre que lhe for solicitado a nota fiscal de aquisição, passar informação ao fabricante (Welmy), onde serão passados dados da assistência técnica mais próxima.

A garantia não abrange:

- Serviços de manutenção para correção de danos decorrentes do uso indevido do equipamento;
- Serviços de instalação de infra-estrutura para o produto (instalações elétricas, suportes mecânicos);
- Reposição de materiais naturalmente desgastados pelo uso;
- Despesas eventuais de transporte, embalagem, seguro, etc.

Extinção da garantia

Fica automaticamente extinta a presente garantia se o produto sofrer danos por acidentes ou agentes da natureza, por exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, se utilizado indevidamente ou consertado por profissional não autorizado e pelo término do período de vigência.

Observação: Todas e quaisquer dúvidas quanto as condições de garantia deverão ser esclarecidas diretamente com o fabricante.

Modelo: _____ nº de série: _____ Prazo: 01 Ano

Welmy®

Rua Irmã Anneta Scnapp, 81 - Distrito Industrial II - Santa Bárbara d' Oeste - SP
CEP 13457-194 - Fone: (19) 3026.2566 www.welmy.com.br

Cód 59444 - RV 03

Welmy®

Manual do Usuário



Balança Mecânica Adulto


Modelo 110 CH / 110 CHG / 104 A

Características e Especificações

Balança Mecânica para pesar pessoas.

A sua balança WELMY foi projetada cuidadosamente para ter um desempenho seguro e confiável por muitos anos. Entretanto, quando se trata de um equipamento de pesagem, há algumas precauções básicas que devem ser tomadas para evitar danos à unidade.

Modelo	Carga Máxima	Carga Mínima	Divisão	Medida Plataforma
110 CH	150 kg	2 kg	100 g	375 x 290 mm
110 CHG	180 kg	2 kg	100 g	375 x 290 mm
104 A	300 kg	2 kg	100 g	540 x 380 mm

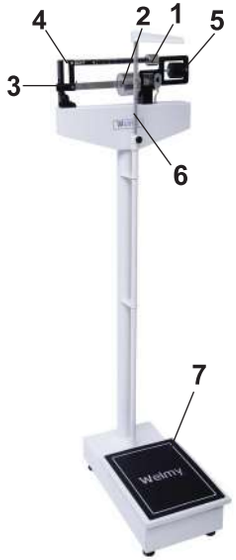

m 1 e 2 : Cursor maior e menor (indicam os pesos);
m 3 e 4 : Fiel e União da régua (equilíbrio p/ indicação de peso);
m 5: Regulador de zero (nivela as pontas do fiel e união da régua);
m 6: Antropômetro (medição da altura);
m 7: Plataforma de pesagem.

Desembalar

- Retirar a embalagem de papelão cuidadosamente;
- Retirar as fitas protetoras que prendem as réguas e cursores;

Instalação

Sempre instalar o equipamento em um local fixo e nivelado, isento de vibrações e livre de corrente de ar muito forte, tais como ventiladores.

Use os pés niveladores para melhor posicionamento do equipamento, mantendo sempre nivelado.

Após a instalação do equipamento, torna-se obrigatória a notificação ao INMETRO sobre o equipamento de pesagem ou medição. Segue abaixo procedimento para localização do órgão de fiscalização mais próximo para pesos e medidas:

www.inmetro.gov.br (selecionar na parte superior direita ‘‘Inmetro nos estados’’)

Operação

- Deixar os dois cursores na escala zero a fim de obter o equilibrio das réguas, caso necessário, girar o regulador de zero até obter o mesmo;
- Após subir o paciente na balança, movimentar o cursor maior (kg) sobre a régua, juntamente com o cursor menor (g) até o conjunto de réguas fique em equilíbrio total, obtendo esse equilíbrio, faça a leitura do cursor maior em quilogramas e do cursor menor em gramas, que é o resultado da pesagem.
- Movimentar ou deslocar frequentemente o equipamento de pesagem do seu local de instalação, pode acarretar em perda da calibração se não for realizado por um profissional capacitado.
- Orientamos uma calibração preventiva do equipamento a cada 06 meses de utilização.

Cuidados e Manutenção

Para a limpeza do equipamento, utilizar somente pano úmido e sabão neutro. Jamais utilizar solventes, detergentes, álcool ou thinner.

Evitar mudar o equipamento de local frequentemente, caso necessário, transportar e manusear com cuidado.

Nunca aplicar tensões ou compressões bruscas sobre a plataforma de pesagem, sob o risco de danificar o receptor de carga.

assistências técnicas, encontram-se no site www.welmy.com.br ou pelo e-mail suporte@welmy.com.br.